


PROTOKOL Z MĚŘENÍ

č. PM_TTP_OPT_RR_MM_DD_XX

číslo objednávky 123456
zadavatel ZČU, TTP
označení vzorku zadavatel S123456
 NTC 200904-001/001
měřená veličina spektrální normálová emisivita
metoda měření SNEHT
teplota (T) 900°C
polární úhel 0°
datum měření 30.3.2021
měření provedl Ilona Slavíková
odpovědná osoba Ing. Petra Honnerová, Ph.D. tel.: +420 735 713 911
 e-mail: petrahon@ntc.zcu.cz

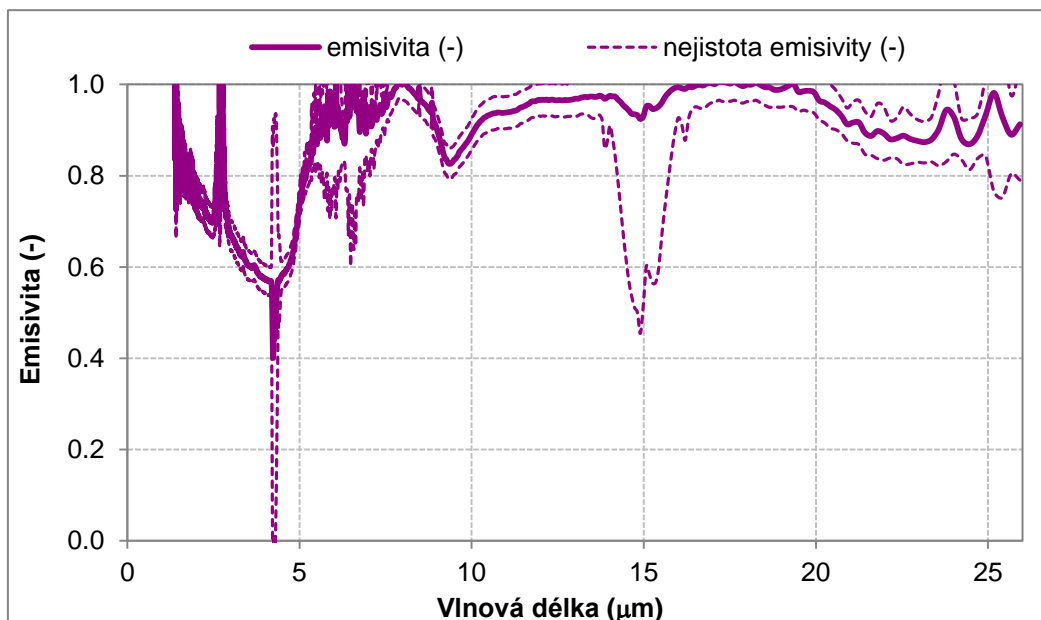

vlnová d. (um)	2	3.5	4.7	8.3	10	12.5	17.5	20	25
emisivita (-)	0.765	0.605	0.605	0.982	0.892	0.966	1.002	0.983	0.932
nej. (-), k = 2	0.034	0.032	0.031	0.036	0.034	0.036	0.041	0.046	0.049