

PROTOKOL Z MĚŘENÍ

č. PM_TTP_OPT_RR_MM_DD_XX

číslo objednávky 123456
zadavatel ZČU, TTP


označení vzorku zadavatel S123456
NTC 210417-001/002

veličina spektrální normálová hemisférická odrazivost absolutní
metoda měření SNHRRT/V1 - UV-VIS-NIR
teplota (T) 25°C
polární úhel (θ) 8°
azimutální úhel (φ) 0°, 45°, 90°, 135°

datum měření 17.4.2021

měření provedl Ilona Slavíková

odpovědná osoba Ing. Petra Honnerová, Ph.D. tel.: +420 735 713 911
e-mail: petrahon@ntc.zcu.cz

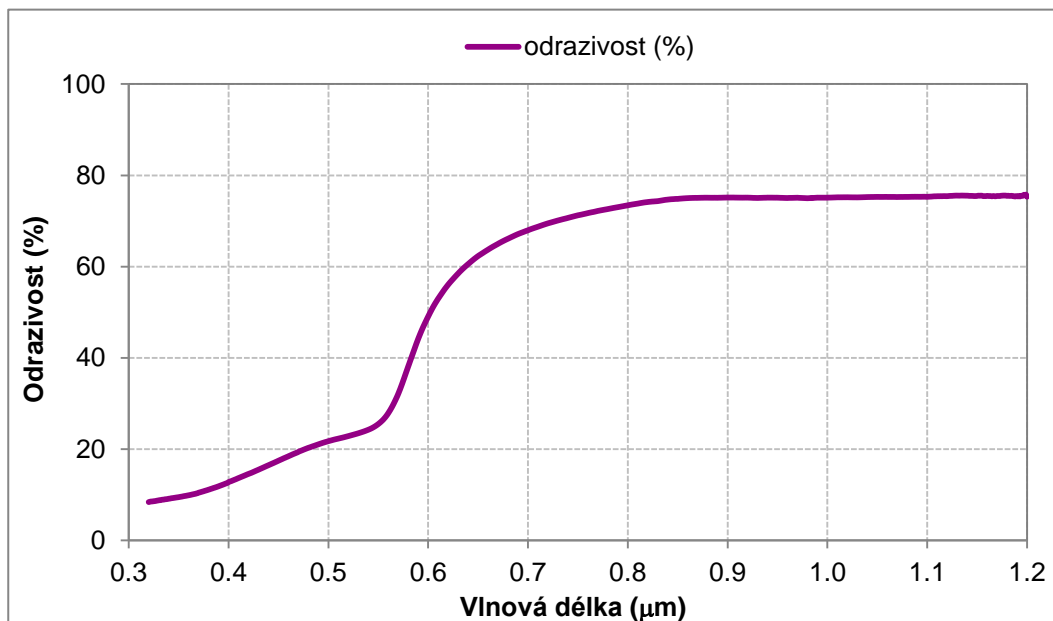

vlnová d. (um)	0.35	0.40	0.50	0.60	0.80	1.00	1.10	1.20
odrazivost (%)	9.5	12.7	21.7	49.0	73.4	75.1	75.3	75.3