


# PROTOKOL Z MĚŘENÍ

č. PM\_TTP\_OPT\_RR\_MM\_DD\_XX

**číslo objednávky** 123456  
**zadavatel** ZČU, TTP  
**označení vzorku** zadavatel S123456  
 NTC 210417-001/003  
**veličina** spektrální normálová hemisférická propustnost  
**metoda měření** SNHTRT - MIR, nástavec Z1  
**teplota (T)** 25°C  
**polární úhel ( $\theta$ )** 0°  
**datum měření** 17.4.2021  
**měření provedl** Ilona Slavíková  
**odpovědná osoba** Ing. Petra Honnerová, Ph.D. tel.: +420 735 713 911  
 e-mail: petrahon@ntc.zcu.cz

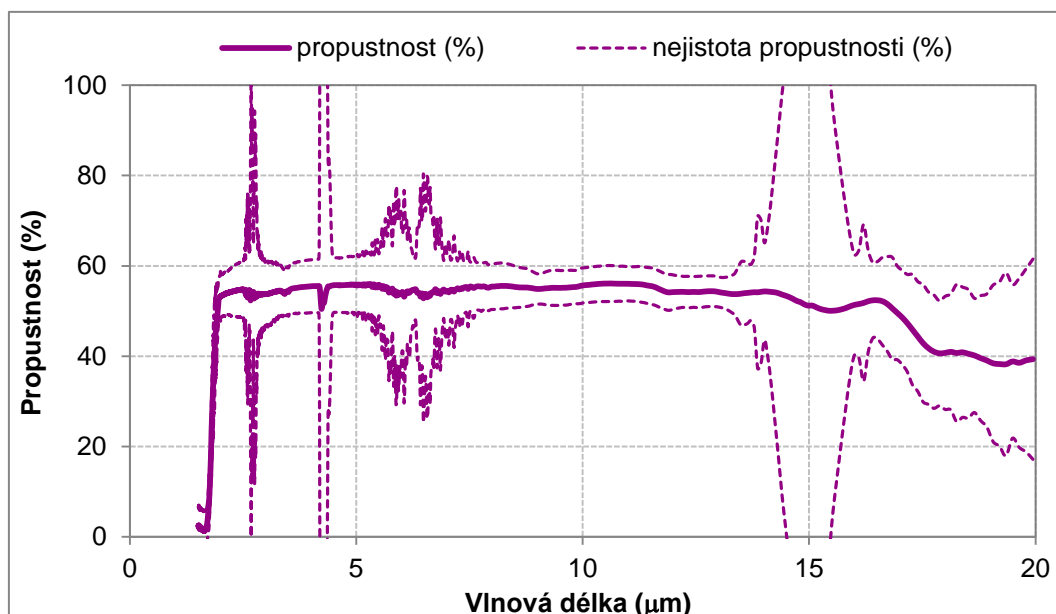

vlnová d. (um)	2	3.7	4.7	8.3	10	12.5	17.5	20
propustnost (%)	53.2	55.2	55.7	55.6	55.7	54.2	42.9	39.3
nej. (%), k = 2	5.0	5.7	6.1	4.9	3.9	3.5	13.0	22.2