

PROTOKOL Z MĚŘENÍ


č. PM_TTP_OPT_RR_MM_DD_XX

číslo objednávky 123456
zadavatel ZČU, TTP

označení vzorku zadavatel S123456
NTC 210417-001/003

veličina spektrální normálová hemisférická propustnost
metoda měření SNHTRT - UV-VIS-NIR
teplota (T) 25°C
polární úhel (θ) 0°

datum měření 17.4.2021
měření provedl Ilona Slavíková
odpovědná osoba Ing. Petra Honnerová, Ph.D. tel.: +420 735 713 911
e-mail: petrahon@ntc.zcu.cz

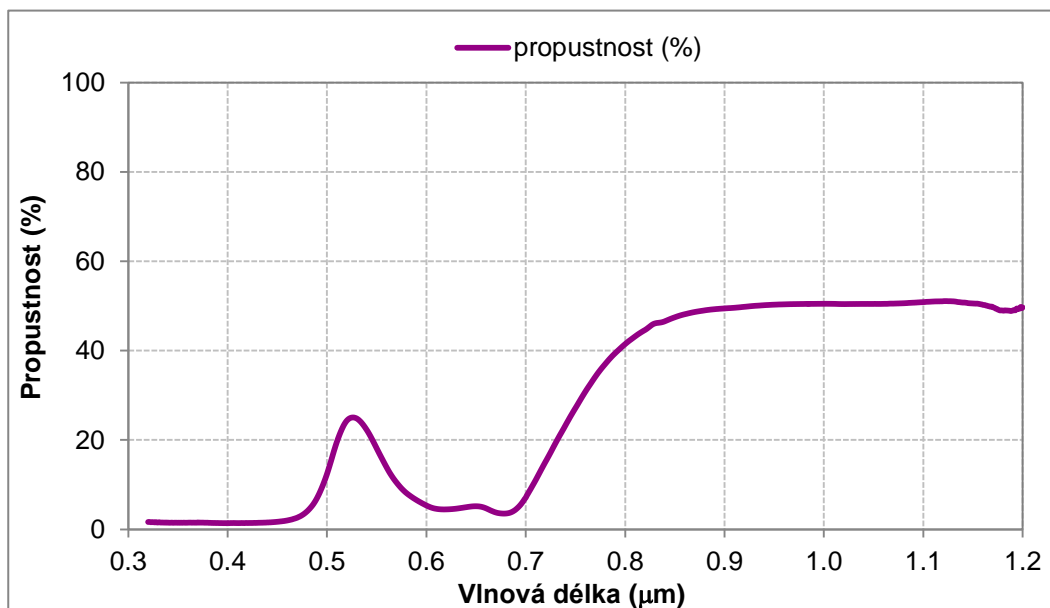

vlnová d. (μm)	0.35	0.40	0.50	0.60	0.80	1.00	1.10	1.20
propustnost (%)	1.5	1.4	12.4	5.4	41.5	50.5	50.9	49.7